



manueller AO-Typ Phoropter **Rexxam BR-7**

mit bewährter Technologie - präzise, robust und zuverlässig.

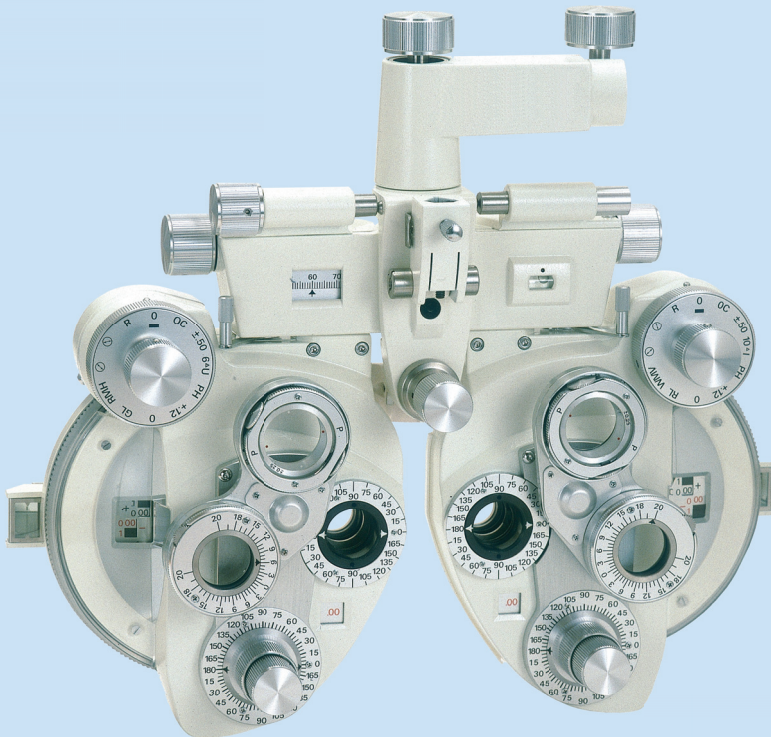

Rexxam
Quality in vision care

Proudly  Made in Japan



bon



Technische Details Phoropter Rexam BR-7

PD-Einstellung	48 bis 75 mm, 1 mm Schritte
Sphärischer Messbereich	+16,75 bis -19,00 Dpt.
Zylinder Messbereich	0 bis - 6,00 Dpt. in 0,25 Dpt. Schritten mit Zusatzlinse bis - 8,00 Dpt.
Zylinder Achse	0 bis 180°, in 5° Schritten
Kreuzzylinder	+/- 0,25 Dpt.
Prismenkompensator	0 bis 20 PrDpt.
Entspiegelung der Gläser	Wahlweise mit oder ohne Vergütung

Hilfslinsen

offene Apertur in 2 Positionen, Skiaskopierlinse + 1,5 Dpt.,
Polarisationsfilter: 45° und 135° (links), 135° und 45° (rechts),
Maddox-Filter weiß (links), Maddox-Filter rot (rechts),
Rotfilter (links), Grünfilter (rechts), 1/8 Dpt. Linse, Lochblende,
Trennungsprisma 10 PrDpt. (links), Trennungsprisma 6 PrDpt.
(rechts), Occluder, feststehender Kreuzzylinder +/- 0,50 Dpt.

Zusatzlinsen

je 2x 0,25 Dpt. und 2,00 Dpt. Cylinderlinsen,
2x Planlinsen zum Verschließen der Frontöffnung

Standard-Zubehör

Nahprüfplatte mit Halter und Nahlesestange,
Staubschutzhaube, Hygieneabdeckungen (Gesichtsschilder)

Maße	318 x 293 x 96 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg
Montage	AO-Typ Standardaufnahme
Gehäusefarbe	Perlweiß, ähnlich RAL 1013

Änderungen an Design und Technik jederzeit vorbehalten.
TOWA Medical Instruments Co., Ltd., 1698-2 Nakano, Nakano-shi, Nagano, 383-0013, Japan

Rev. 2022-05-05